



## Báscula para bebés

# MANUAL DE USUARIO **MS3500**



Mantenga el manual de instrucciones a mano y siga las instrucciones de uso.



# TABLA DE CONTENIDO

<b>Explicación de textos/símbolos en la etiqueta/empaque del dispositivo</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Notas de seguridad</b> .....	<b>6</b>
A. Información general .....	6
B. Directrices EMC y declaración del fabricante .....	10
<b>II. Instalación</b> .....	<b>15</b>
A. Bandeja de fijación .....	15
B. Accesorio para medir la altura .....	15
C. Inserción de las pilas .....	17
D. Uso del adaptador de CA .....	18
<b>III. Indicadores y funciones clave</b> .....	<b>19</b>
<b>IV. Uso del dispositivo</b> .....	<b>20</b>
A. Funcionamiento básico .....	20
B. Tare .....	20
C. Hold .....	21
<b>V. Configuración del dispositivo</b> .....	<b>22</b>
<b>VI. Solución de problemas</b> .....	<b>25</b>
Mensajes de error .....	27
<b>VII. Especificaciones del producto</b> .....	<b>29</b>
A. Información del dispositivo .....	29
B. Estándares del adaptador de corriente .....	30
<b>VIII. Declaración de Conformidad</b> .....	<b>31</b>

## Explicación de textos/símbolos en la etiqueta/empaquetado del dispositivo

Texto/Símbolo	Significado
	Precaución, consulte los documentos adjuntos antes de usar
	Recogida separada de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la Directiva 2002/96/EC. No deseche el dispositivo con los residuos domésticos
	Nombre y dirección del fabricante del dispositivo, y año/país de fabricación
	Lea detenidamente el manual del usuario antes de la instalación y el uso, y siga las instrucciones de uso.
	Dispositivo médico eléctrico, parte aplicada tipo B
	Dispositivo médico eléctrico, parte aplicada tipo BF
<b>REF</b>	Número de catálogo del dispositivo / número de modelo
<b>EC REP</b>	Nombre y dirección del representante autorizado en la Unión Europea
<b>MDI</b>	El dispositivo es un dispositivo médico. El texto indica el tipo de categoría del dispositivo
<b>LOT</b>	Número de lote o de serie del fabricante del dispositivo
<b>SN</b>	Número de serie del dispositivo
<b>UDI</b>	Identificador único del dispositivo
<b>e</b>	Intervalo de escala de verificación. Valor expresado en unidades de masa. Utilizado para clasificar y verificar un instrumento
<b>CE</b> 2460	El dispositivo cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. El número de cuatro dígitos es el identificador del organismo notificado de productos sanitarios

El dispositivo cumple con las directivas CE (solo para modelos verificados)

CE M20 0122

**M**: C Etiqueta de conformidad según la Directiva 2014/31/UE para instrumentos de pesaje no automáticos  
**20**: Año en que se realizó la verificación de conformidad y se aplicó la etiqueta CE. (ej: 16=2016)  
**0122**: Identificador del organismo notificado de metrología



El dispositivo es una báscula de Clase III conforme a la Directiva 2014/31/UE (solo modelos verificados)



Nombre y dirección de la entidad que importa el dispositivo (si corresponde)



Nombre y dirección de la entidad responsable de la traducción de la información de uso (si corresponde)

CON.

Contador de eventos que confirma cuántas veces se ha calibrado el dispositivo (si corresponde)



El dispositivo cumple con la aprobación de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán (NCC)



El dispositivo cumple con las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

UK M 20 8506

El dispositivo cumple con las normativas del Reino Unido de 2016 sobre instrumentos de pesaje no automáticos (solo modelos verificados)  
**M**: Etiqueta de conformidad según las normativas del Reino Unido de 2020 sobre instrumentos de pesaje no automáticos  
**20**: Año en el que se realizó la verificación de conformidad y se aplicó la etiqueta UKCA (ej: 20=2020)  
**8506**: Identificador del organismo de metrología aprobado



El dispositivo cumple con toda la legislación de productos aplicable en el Reino Unido



Polaridad de la alimentación del dispositivo Polaridad de la alimentación del dispositivo.

" En caso de diferencias, el ícono en el propio dispositivo tiene prioridad "

**Aviso de derechos de autor**  
**Charder Electronic Co., Ltd.**

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Sitio web: [www.chardermedical.com](http://www.chardermedical.com)

E-mail: [info\\_cec@charder.com.tw](mailto:info_cec@charder.com.tw)

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Este manual de usuario está protegido por la ley internacional de derechos de autor. Todo el contenido está licenciado, y su uso está sujeto a la autorización escrita de Charder Electronic Co., Ltd. (en adelante Charder) Charder no se hace responsable de los daños causados por no cumplir con los requisitos establecidos en este manual. Charder se reserva el derecho de corregir errores tipográficos en el manual sin previo aviso, y de modificar el exterior del dispositivo por razones de calidad sin el consentimiento del cliente.



Charder Electronic Co., Ltd.  
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,  
Taichung City, 41262 Taiwan

# I. Notas de seguridad

## A. Información general

Gracias por elegir este dispositivo médico de Charder. Está diseñado para ser fácil y sencillo de operar, pero si encuentra algún problema que no se aborde en este manual, póngase en contacto con su socio de servicio local de Charder.

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, lea atentamente este manual del usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Contiene instrucciones importantes sobre la instalación, el uso adecuado y el mantenimiento.

## Propósito previsto

Este dispositivo médico está diseñado para ser utilizado de acuerdo con las normativas nacionales, para medir el peso dentro de las especificaciones, para un uso relacionado con el peso por profesionales.

Para mantener la coherencia, el término 'paciente' se utilizará para referirse a los lactantes o niños pequeños en el resto de este documento.

Patient is placed on a tray or sling which is attached to a weighing platform for the device to measure patient weight.

## Beneficio clínico

Los resultados de la medición pueden ser utilizados por los profesionales para diagnosticar (y monitorear) problemas relacionados con el peso.

## Indicaciones/contraindicaciones médicas previstas

Medición: peso corporal del sujeto. No se conocen contraindicaciones para la medición del peso corporal.

## **Perfil del paciente previsto**

- (a) Edad: sin restricciones (sujeto a las limitaciones de tamaño del dispositivo y capacidad máxima)
- (b) Peso: sin restricciones dentro de la capacidad de peso del dispositivo
- (c) Condiciones del paciente: Requiere la medición del peso corporal. Puede colocarse en el dispositivo.

## **Perfil del usuario previsto**

- (a) Tener al menos 20 años
- (b) Conocimientos mínimos:
  - Capaz de leer a nivel de escuela secundaria y de comprender los números arábigos (por ejemplo 1, 2, 3, 4...)
  - Conocimientos básicos de higiene
  - Capacitado en el uso del dispositivo
  - Leer el manual de instrucciones
- (c) Idioma
  - Capaz de leer el idioma del manual de instrucciones y las instrucciones en pantalla
- (d) Calificaciones
  - No se requieren certificaciones o calificaciones especiales

## **Evaluación del riesgo residual**

- (a) Todos los riesgos previsibles han sido evaluados y considerados aceptables. En términos generales, el riesgo más probable causado por un uso incorrecto del dispositivo es una medición menos precisa (o la incapacidad de utilizar el dispositivo para obtener una medición), lo cual no representa un riesgo físico inminente para el paciente o el usuario.
- (b) La relación beneficio-riesgo se considera aceptable. Las balanzas para bebés son una opción importante para medir a los pacientes. Es poco probable que el uso del dispositivo cause daño al usuario o al paciente.

## **Manejo general**

- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente bloqueadas y apretadas antes de utilizar el dispositivo.
- La precisión de la medición requiere que los pies, la espalda y la cabeza del sujeto estén alineados. Tenga en cuenta que la altura puede variar a lo largo del día.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice junto a equipos que puedan causar interferencias electromagnéticas u otros tipos de interferencias.

## **Instrucciones de seguridad**

Antes de usar el dispositivo, lea este manual de usuario detenidamente. Contiene instrucciones importantes para la instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo.

El fabricante no será responsable de los daños causados por no seguir las siguientes instrucciones:

- El dispositivo tiene una vida útil esperada de 5 años cuando se maneja, se mantiene y se inspecciona periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Una instalación incorrecta anulará la garantía.
- Observe las temperaturas ambientales permitidas para el uso.

## **Limpieza**

- La superficie del dispositivo debe limpiarse con toallitas a base de alcohol.

## **Mantenimiento**

- Póngase en contacto con su distribuidor local de Charder para el mantenimiento y la calibración regulares; se recomienda una revisión periódica de la precisión, cuya frecuencia dependerá del nivel de uso y del estado del dispositivo.

## **Garantía/Responsabilidad**

- El período de garantía será de dieciocho (18) meses, comenzando en la fecha de compra. Conserve su recibo como comprobante de compra.
- No se aceptará responsabilidad por daños causados por las siguientes razones: almacenamiento o uso inadecuado, instalación o puesta en servicio incorrecta por parte del propietario o terceros, desgaste natural, cambios o modificaciones, manejo incorrecto o negligente, interferencia química, electroquímica o eléctrica, a menos que el daño sea atribuible a la negligencia de Charder.
- Este dispositivo no contiene partes que el usuario pueda mantener. Todo el mantenimiento, las inspecciones técnicas y las reparaciones deben ser realizadas por un distribuidor autorizado de Charder, utilizando accesorios y piezas de repuesto originales de Charder. Charder no será responsable de los daños derivados del mantenimiento o uso inadecuado. Desmontar el dispositivo anulará la garantía.

## **Informe de Incidentes**

- Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe ser informado al fabricante, al representante de la UE (si el dispositivo se utiliza en un estado miembro de la UE) y a la autoridad competente del estado miembro del usuario/paciente.

## B. Directrices EMC y declaración del fabricante

<b>Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas</b>		
<p>El producto está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.</p>		
<b>Prueba de emisión</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ambiente electromagnético guía</b>
RF emissions CISPR 11	Gruppe 1	La báscula pesa personas utiliza energía RF solo para su función interna. Por tanto, sus emisiones RF son muy bajas y verosímilmente no causan ninguna interferencia en los aparatos electrónicos.
RF emissions CISPR 11	Klasse A	La báscula pesa personas es adecuado para utilizarse en todos los centros sanitarios u hospitalarios, conectados a la red de alimentación pública de baja tensión.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Klasse A	
Voltage fluctuations /flicker emissions IEC 61000-3-3	Cumplimiento	

### Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity

El producto está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	Conformidad IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Ambiente electromagnético guía
Electrostatic discharge(ESD) IEC 61000-4-2	<u>8 kV contacto</u> <u>± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire</u>	<u>± 8 kV contacto</u> <u>± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire</u>	Los suelos deberían ser de madera, hormigón o cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa deberá ser de al menos el 30%
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	<u>±2Kv</u> <u>suministro eléctrico</u>	<u>±2kV</u> <u>suministro eléctrico</u>	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	<u>±1kV line(s) to line(s)</u> <u>±2kV line(s) to earth</u>	<u>±1kV line(s) to line(s)</u> <u>±2kV line(s) to earth</u>	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital.
Voltage Dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<u>0% U<sub>T</sub> para 0,5 ciclo</u> <u>0% U<sub>T</sub> para 1 ciclo</u> <u>70% U<sub>T</sub> (30% dip in U<sub>T</sub>) para 25 ciclo</u> <u>0% U<sub>T</sub> para 5 ciclo</u>	<u>0% UT para 0,5 ciclo</u> <u>0% UT para 1 ciclo</u> <u>70% UT (30% dip in UT) para 25 ciclo</u> <u>0% UT para 5 ciclo</u>	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital. Si el usuario necesita un funcionamiento continuo del instrumento, se recomienda alimentar el instrumento desde un grupo de continuidad o una batería.
Power frequency(50, 60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	<u>30 A/m</u>	<u>30 A/m</u>	La calidad de la tensión de red debería ser la de un ambiente típico comercial o de hospital.

NOTA UT es el voltaje de la corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba.

## Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética.

El cliente o el usuario del producto debe asegurarse de que se utilice en dicho entorn.

Prueba de inmunidad	Conformidad IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Ambiente electromagnético guía
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz to 80 MHz  <u>6 V in ISM bands between 0,15 MHz and 80 MHz</u> <u>80 % AM at 1 kHz</u>	3 Vrms 150 KHz to 80 MHz  <u>6 V in ISM bands between 0,15 MHz and 80 MHz</u> <u>80 % AM at 1 kHz</u>	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the product including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> <p><b>Distancia de separación recomendada:</b> Los equipos de comunicación RF portátiles y móviles se utilizarán respetando la distancia de separación recomendada por la ecuación siguiente:  <math>d = 1.2 \sqrt{P}</math> entre 150 kHz y 80 MHz  <math>d = 1.2 \sqrt{P}</math> entre 80 MHz y 800 MHz  <math>d = 2.3 \sqrt{P}</math> entre 800 MHz y 2.7 GHz                      P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor e d es la distancia de separación recomendada en metros(m).</p> <p>Intensidad de campo de los transmisores RF fijos, determinada por una inspección electromagnética in situ<sup>a</sup>, debe ser inferior al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencias<sup>b</sup>.</p> <p>Pueden producirse interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> 
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m <u>80MHz to 2,7 GHz</u>	3 V/m <u>80MHz to 2,7 GHz</u>	

NOTA1 : A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de la frecuencia más alta.

NOTA2 : Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética está

influenciada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.

- a Las intensidades de campo para transmisores fijos, como las estaciones de base para radiotéfonos(móviles e inalámbricos) y radio móviles terrestres, aparatos de radioaficionados, transmisores radio en AM y FM y transmisores TV, no pueden preverse teóricamente y con precisión. Para establecer un ambiente electromagnético causado por transmisores RF fijos, debería realizarse un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el dispositivo supera el nivel de conformidad aplicable antes citado, debe ponerse bajo observación el funcionamiento normal del dispositivo. Si se notan prestaciones anormales, pueden ser necesarias medidas adicionales, como una distinta orientación o posición del dispositivo.
- b La intensidad de campo en un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz debería ser menor de 3V/m.

**Distancias de separación recomendadas  
entre aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles**

La báscula pesa personas está prevista para funcionar en un ambiente electromagnético donde están bajo control las interferencias irradiadas RF. El cliente o el operador del dispositivo pueden contribuir a prevenir las interferencias electromagnéticas, garantizando una distancia mínima entre los aparatos de comunicación móviles y portátiles de RF (transmisores) y el dispositivo, como se recomienda a continuación, en relación con la potencia de salida máxima de los aparatos de radiocomunicación.

Potencia de salida nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación a la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2.7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23


Para los transmisores con potencia nominal máxima de salida no indicada arriba, la distancia de separación recomendada  $d$  en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde  $P$  es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en Vatios (W), según el fabricante del transmisor.

Notas: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de la frecuencia más alta. Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética está influenciada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.


## II. Instalación

### A. Bandeja de fijación


1. Deslice la bandeja sobre el dispositivo.

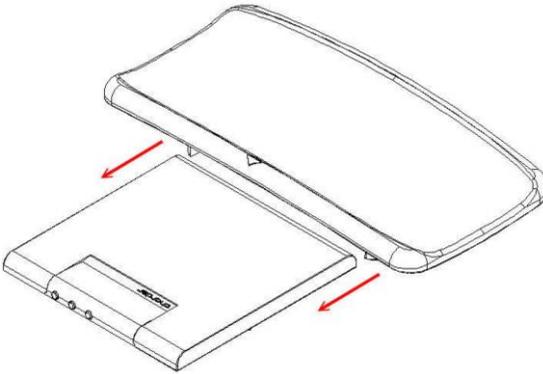

2. Dé vuelta el dispositivo. Fije la bandeja al dispositivo girando la perilla a cada lado de la bandeja (gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar, gire en el sentido contrario de las agujas del reloj para aflojar).

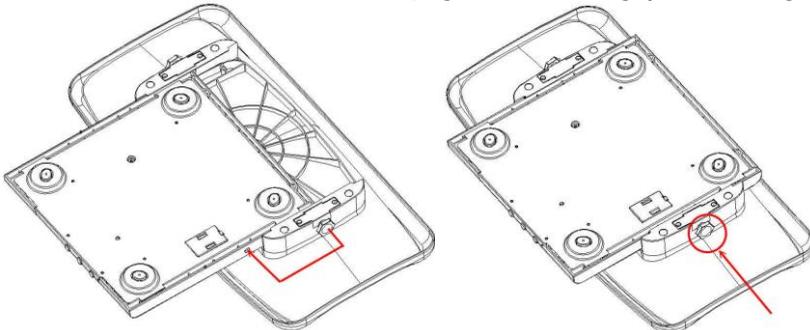

3. Ahora se puede utilizar el dispositivo para realizar mediciones.

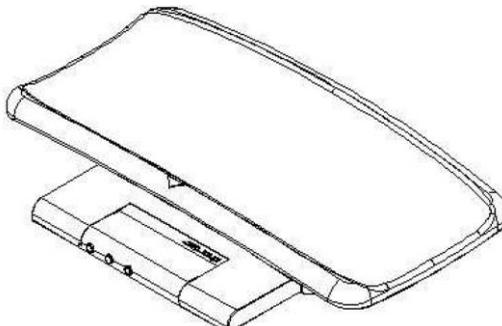


### B. Accesorio

para medir



## la altura

1. Coloque el soporte en el dispositivo y en la bandeja del bebé y ajuste los tornillos con un destornillador.

Bracket

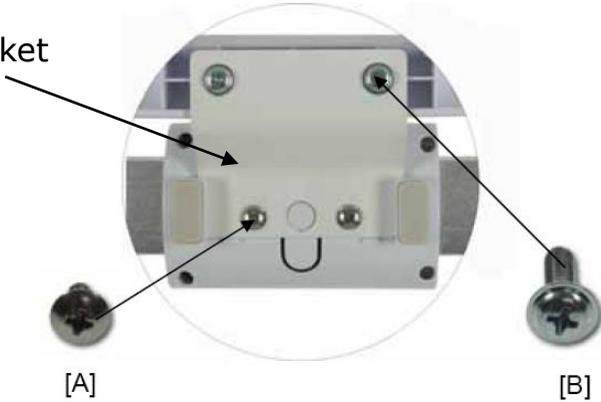

2. Conecte el accesorio de medición de altura al soporte. Se oirá un clic.

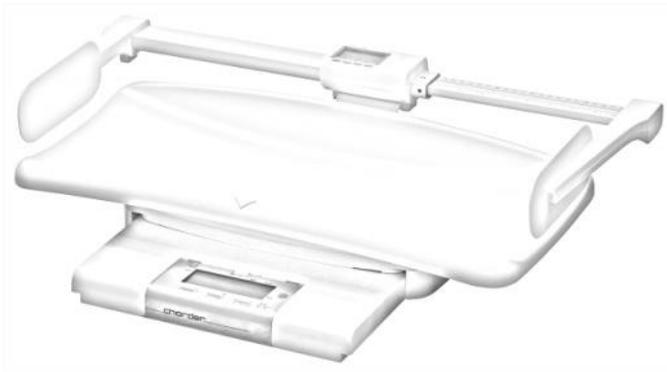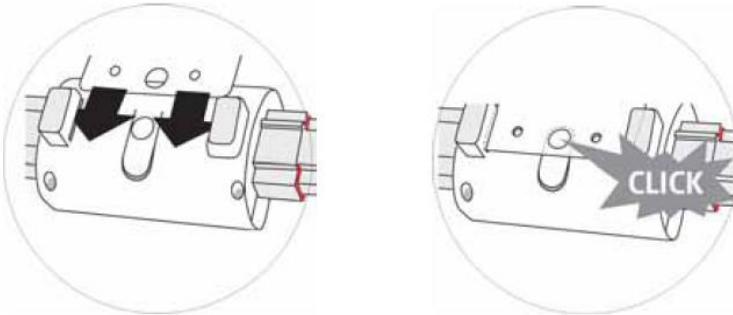

### C. Inserción de las pilas

1. Localice la tapa de la batería en la parte inferior del dispositivo.
2. Saque el conector de la batería de la carcasa.



3. El dispositivo utiliza una batería de 9 V.

4. Conecte la batería de 9 V al conector.




5. Coloque la batería en la carcasa. Cierre la tapa y gire la balanza hacia la derecha. Encienda el dispositivo para comprobar si las baterías están instaladas correctamente.




#### D. Uso del adaptador de CA

El dispositivo se puede alimentar a través de un adaptador mediante el puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo. Conecte el adaptador al dispositivo antes de enchufarlo a la red eléctrica.

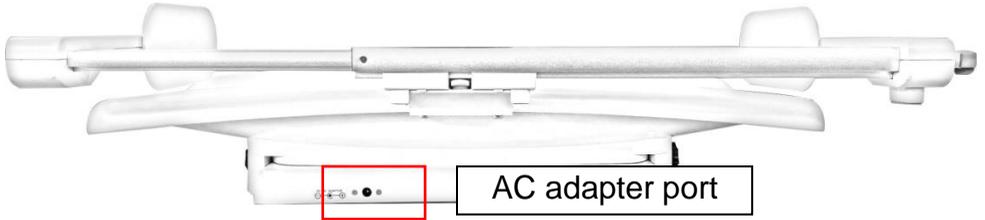

### III. Indicadores y funciones clave

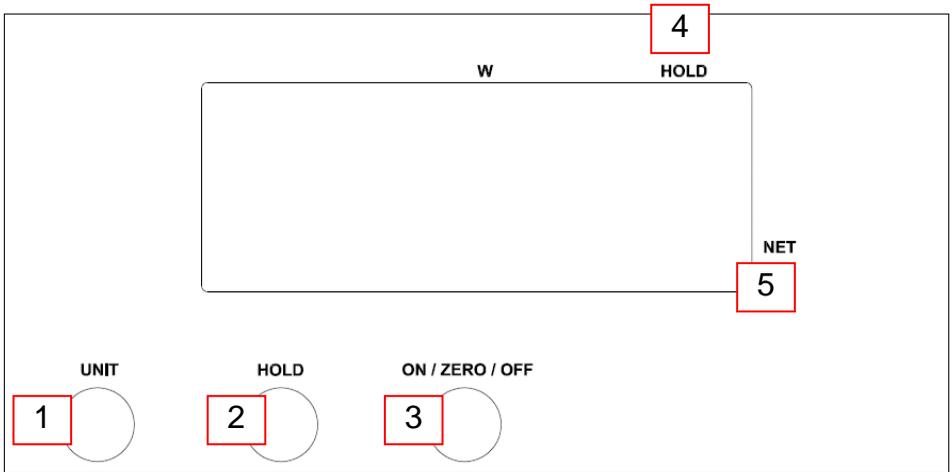

#### **Función de la tecla s**

1. **UNIT**: Cambia entre kg/ lb
2. **HOLD**: Determinar un valor de pesaje estable; se utiliza cuando el peso es inestable
3. **ON/ZERO/OFF**: Enciende y apaga el dispositivo. Pon a cero la escala ( $\pm 2$  % de la capacidad total) . Mantén presionado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

#### **Indicador**

4. Hold: La función Hold está activa
5. Net: el resultado actual es el peso neto

## IV. Uso del dispositivo

### A. Funcionamiento básico

Encienda el dispositivo con la tecla **[ON/ZERO/OFF]** . El dispositivo realizará automáticamente una autocalibración y mostrará la versión del software.

Una vez que aparezca "0,00 kg" en el indicador, el dispositivo estará listo para la medición.

**Nota** : Si no aparece "0,00 kg" en el indicador, presione la tecla **[ON/ZERO/OFF]** para poner el dispositivo a cero. Esta función se puede utilizar para pesos dentro de  $\pm 2 \%$  de la capacidad total .

Coloque con cuidado el objeto sobre la plataforma de medición. Una vez que el peso se haya estabilizado, aparecerá el símbolo "estable" en el indicador.

**Nota** : Si el peso del sujeto excede la capacidad de la báscula (incluida la tara), el indicador mostrará el mensaje "Err" debido a la sobrecarga.

### B. Tare

La función de tara permite al usuario deducir el peso de los objetos del resultado de la medición del dispositivo. La tara se puede utilizar cuando el peso del objeto es  $\geq$  igual o superior al 2 % de la capacidad de 20 kg.

1. Coloque el objeto que necesita ser tarado sobre la plataforma de medición.
2. Pulse la tecla **[ON/ZERO/OFF]** después de que aparezca el símbolo de estabilidad en el indicador. La pantalla indicará "0,00 kg".
3. Coloque el objeto (más el objeto tarado) que se va a pesar sobre la plataforma de medición. Realice la

medición.

4. Para borrar el valor de tara, retire todos los objetos de la plataforma de medición y presione la tecla **[ON/ZERO/OFF]**.

### **C. Hold**

La función de retención determina el peso promedio, diseñada para usarse si el peso del sujeto no se estabiliza (por ejemplo, un bebé activo).

**Nota:** si la fluctuación es demasiado severa, la determinación del peso promedio será difícil y la retención puede no funcionar correctamente.

1. Encienda el dispositivo normalmente.
2. Pulse la tecla **[HOLD]** . En el indicador aparecerá "HOLD".
3. Coloque con cuidado el objeto sobre la plataforma de medición.
4. Después de unos segundos, el peso promedio se mostrará en el indicador. Este peso se bloqueará; en este momento, se puede eliminar al sujeto del dispositivo.
5. Para liberar el peso bloqueado, presione la tecla **[HOLD]** nuevamente para regresar el dispositivo al modo normal.

**Nota :** La función de retención se puede activar antes o después de colocar al sujeto en la plataforma de medición. Sin embargo, si al sujeto le resulta difícil permanecer quieto, recomendamos activar la función de retención después de colocar al sujeto en la plataforma.

## V. Configuración del dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado , mantenga presionada la tecla **[ON/ZERO/OFF ]** . Escuchará un pitido. Sin soltar la tecla **[ON/ZERO/OFF]** , presione **[UNIT]** 3 veces y suelte la tecla **[ ON/ZERO/OFF ]** . La pantalla mostrará la versión del software seguida de "Unit " (primera opción en el menú de configuración) .

En la configuración del dispositivo:

**[UNIT]** para alternar la opción del menú

**[HOLD]** para confirmar la selección / ingresar al submenú

Para guardar los cambios, alterne las opciones del menú

usando **[UNIT]** hasta que **End** aparezca , y presione **[HOLD]** para salir de la configuración.

**Unit**

**Unidad:** activar y desactivar unidades.

Opciones de unidad: kg, lb , oz, lb:oz

Pulse **[UNIT]** para alternar entre las opciones de unidad.

Pulse **[HOLD]** para seleccionar una opción de unidad y

pulse **[UNIT]** para alternar entre Activado y Desactivado.

Pulse **[HOLD]** para confirmar la selección.

**AUTOFF**

**Apagado automático** : indica al dispositivo que se apague automáticamente después de un cierto período de tiempo.

Opciones de apagado automático: 120 s / 180 s / 240 s / 300 s / apagado

Pulse **[UNIT]** para seleccionar el tiempo objetivo. Pulse **[ HOLD ]** para confirmar la selección.

**CRP**

**Capacidad** : alternar la capacidad máxima ( esta función solo debe ser modificada por distribuidores calificados)

Opciones de capacidad: 10 kg / 15 kg / 20 kg

Pulse **[UNIT]** para alternar entre las opciones. Pulse **[HOLD]** para confirmar la selección.

**Gr Au**

**Compensación de gravedad** : activa o desactiva la compensación de gravedad (esta función solo debe ser modificada por distribuidores calificados)

Opciones de compensación de gravedad:  
activado/desactivado

Pulse **[UNIT]** para alternar entre encendido y apagado. Pulse **[HOLD]** para confirmar la selección.

Si la compensación de gravedad está **activada** , presione **[ON/OFF/ZERO]** en el menú de configuración para ajustar el valor. Presione **[HOLD]** para ajustar el valor y **[UNIT]** para pasar al siguiente dígito. (Esta función solo debe ser modificada por distribuidores calificados)

Si se requiere calibración, desactive la compensación de gravedad antes de realizar la calibración.

El valor de gravedad para la ubicación del dispositivo se puede ajustar si planeas trasladarlo a otro país. Configurar el valor de gravedad correcto para la nueva ubicación es esencial para mantener la precisión. Comunícate con tu proveedor local de servicios de báscula Charder para obtener ayuda.



**Pitido** : cuando la función está activada, se emitirá un pitido cuando: el indicador esté encendido, se presionen las teclas y el peso sea estable.

Pulse **[UNIT]** para alternar entre encendido y apagado.  
Pulse la tecla **[HOLD]** para confirmar la selección.

## VI. Solución de problemas

### Defectos del producto

Antes de contactar a su distribuidor local de Charder para solicitar servicio de reparación, le recomendamos que tenga en cuenta los siguientes procedimientos de solución de problemas:

### Autoinspección

#### 1. El dispositivo no se enciende

- Si la batería se agota, reemplácela con baterías nuevas.
- Si no se utilizan pilas, compruebe que el adaptador de corriente esté enchufado correctamente al dispositivo. Compruebe que el adaptador de corriente esté enchufado correctamente a la red eléctrica.

#### 2. Indicador que muestra "0000" ZERO SPAN fuera de rango

- Interferencias debidas a factores como perturbaciones de RF o vibraciones del suelo. Reubique el dispositivo en un lugar sin interferencias y vuelva a intentarlo
- Plataforma inestable. Reubica el dispositivo en una ubicación estable y vuelve a intentarlo.
- Objetos externos que interfieren con la plataforma de medición. Limpie la plataforma de objetos y vuelva a intentarlo.
- Es posible que el dispositivo no funcione correctamente en superficies blandas, como alfombras o césped. Reubique el dispositivo en un lugar con un piso sólido y estable.

- Si los pasos anteriores no pueden resolver el problema, es posible que sea necesaria una recalibración para corregir la precisión del pesaje.

## **Se requiere el apoyo del distribuidor**

Si ocurren los siguientes errores, le recomendamos que se comunique con su distribuidor local de Charder para obtener servicios de reparación o reemplazo:

### **1. El dispositivo no se enciende**

- Tecla de encendido/apagado defectuosa
- Cables rotos o dañados que provocan cortocircuito o conexión defectuosa
- Fusible de seguridad fundido
- Adaptador defectuoso

### **2. Daños en el indicador**

- Los posibles defectos de hardware incluyen: brillo desigual en la pantalla LCD, texto borroso, pantalla de arco iris manchada, visualización decimal incorrecta
- No se pueden guardar ni leer datos
- El indicador muestra " **ERRL** " después de encender el dispositivo
- Las teclas no responden
- Mal funcionamiento del timbre

## Mensajes de error

Mensaje de error	Razón	Acción
	<p><b>Advertencia de batería baja</b> El voltaje de la batería es demasiado bajo para que el dispositivo funcione</p>	<p>Reemplace las baterías o conecte el adaptador</p>
	<p><b>Sobrecarga</b> La carga total excede la capacidad máxima del dispositivo</p>	<p>Reducir el peso en la plataforma de medición y volver a intentarlo</p>
	<p><b>Error de conteo (demasiado alto)</b> La señal de las celdas de carga es demasiado alta</p>	<p>El error suele deberse a una celda de carga defectuosa o a un cableado defectuoso. Póngase en contacto con el distribuidor.</p>
	<p><b>Error de conteo (demasiado bajo)</b> La señal de las celdas de carga es demasiado baja</p>	<p>El error suele deberse a una celda de carga defectuosa o a un cableado defectuoso. Póngase en contacto con el distribuidor.</p>

<p>00000</p>	<p>Recuento de cero sobre rango de calibración de cero +10 % mientras está encendido</p>	<p>Se requiere recalibración. Póngase en contacto con el distribuidor.</p>
<p>00000</p>	<p>Recuento cero en el rango de calibración cero -10 % mientras está encendido</p>	<p>Se requiere recalibración. Póngase en contacto con el distribuidor.</p>
<p>Err.E</p>	<p><b>Error de programa</b> Fallo en el software del dispositivo</p>	<p>El error suele deberse a una célula de carga defectuosa o a un cableado defectuoso. Póngase en contacto con el distribuidor.</p>

## VII. Especificaciones del producto

### A. Información del dispositivo


<b>Modelo</b>		<b>MS3500</b>
<b>Medición de peso</b>	<b>Capacidad / Graduación</b>	0-10 kg x 5 g 10-20 kg x 10 g
	<b>Exactitud</b>	± 2e
	<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla LCD de 1,0 pulgadas ( 5 dígitos )
	<b>Unidad</b>	kg/ libra
<b>Dimensiones</b>	<b>Total</b>	560(W) x 342(D) x 105(H) mm
	<b>Bandeja</b>	560(W) x 290(D) x 65(H) mm
	<b>Plataforma</b>	320(W) x 310(D) x 35(H) mm
<b>Peso del dispositivo</b>		2,6 kilogramos
<b>Funciones clave</b>		On/Zero/Off, Hold, Unit
<b>Transmisión de datos</b>		N/A
<b>Fuente de alimentación</b>		Batería de 9 V / Adaptador de corriente
<b>Entorno de operación</b>		+5°C~+35°C 15% / 85% RH 700 hPa ~1060 hPa
<b>Accesorios estándar</b>		Manual de usuario *1 Adaptador de corriente * 1
<b>Accesorios opcionales</b>		Bolsa de transporte, Tallímetro

## B. Estándares del adaptador de corriente



Advertencia

El dispositivo sólo es compatible con el fabricante.  
adaptadores de corriente

VOLTAJE DE AMPERAJE	DIBUJO NÚM.:	N. DE TIPO / N. DE MODELO APROBADO POR LA CE:	TYPE	Enchufe adaptador
12 V0.5A	CD-AD-00028	UES06WOCP-120050SPA	EU	 90 - degree
12 V0.5A	CD-AD-00028	UES06WOCP-120050SPA	US	
12 V0.5A	CD-AD-00028	UES06WOCP-120050SPA	UK	
12 V0.5A	CD-AD-00028	UES06WOCP-120050SPA	AU	

## VIII. Declaración de Conformidad

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas europeas armonizadas, siguiendo las disposiciones de las directivas mencionadas a continuación:

	<b>(EU) 2017/745</b> <b>Reglamento sobre Dispositivos Médicos</b>
	<b>Directiva 2014/31/EU sobre instrumentos de pesaje no automático</b> (solo modelos OIML)

**Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva Delegada (EU) 2015/863**

**Directiva 2014/53/EU sobre equipos radioeléctricos**  
(aplicable si se utiliza un módulo inalámbrico)

### **Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones**

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

*Consulte el documento separado que aparece en la etiqueta del dispositivo para las marcas anteriores.*

Representante autorizado de la EU:



**Obelis s.a.**  
Bd Général Wahis, 53  
B-1030 Brussels  
Belgium



Fabricado por:  
Charder Electronic Co., Ltd.  
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,  
Taichung City, 41262 Taiwan

CD-IN-00930 REV001 10/2024